

Nowość!

Miernik zdolności oddychania maseczek PI-MZDO MAS 02

Miernik do badania zdolności oddychania maseczek według normy PN EN 14683, maski medycznej oraz normy PN-EN 14683 + AC maseczki chirurgiczne.


Miernik składa się z:

- Precyzyjnej cichobieżnej pompy próżniowej o wydajności 10 l/min.
- Cyfrowego miernika różnicy ciśnień o zakresie 1000 Pa i rozdzielczości 0,1/1Pa.
- Przepływomierza z regulacją przepływu.
- Komory pomiarowej o geometrii według norm PN-EN14683 i PN-EN 14683 + AC.
- Miernik jest kompaktowej obudowie do podłączenia pompy próżniowej.

Zapraszamy do kontaktu

Wojciech Kaca

tel. 602191869

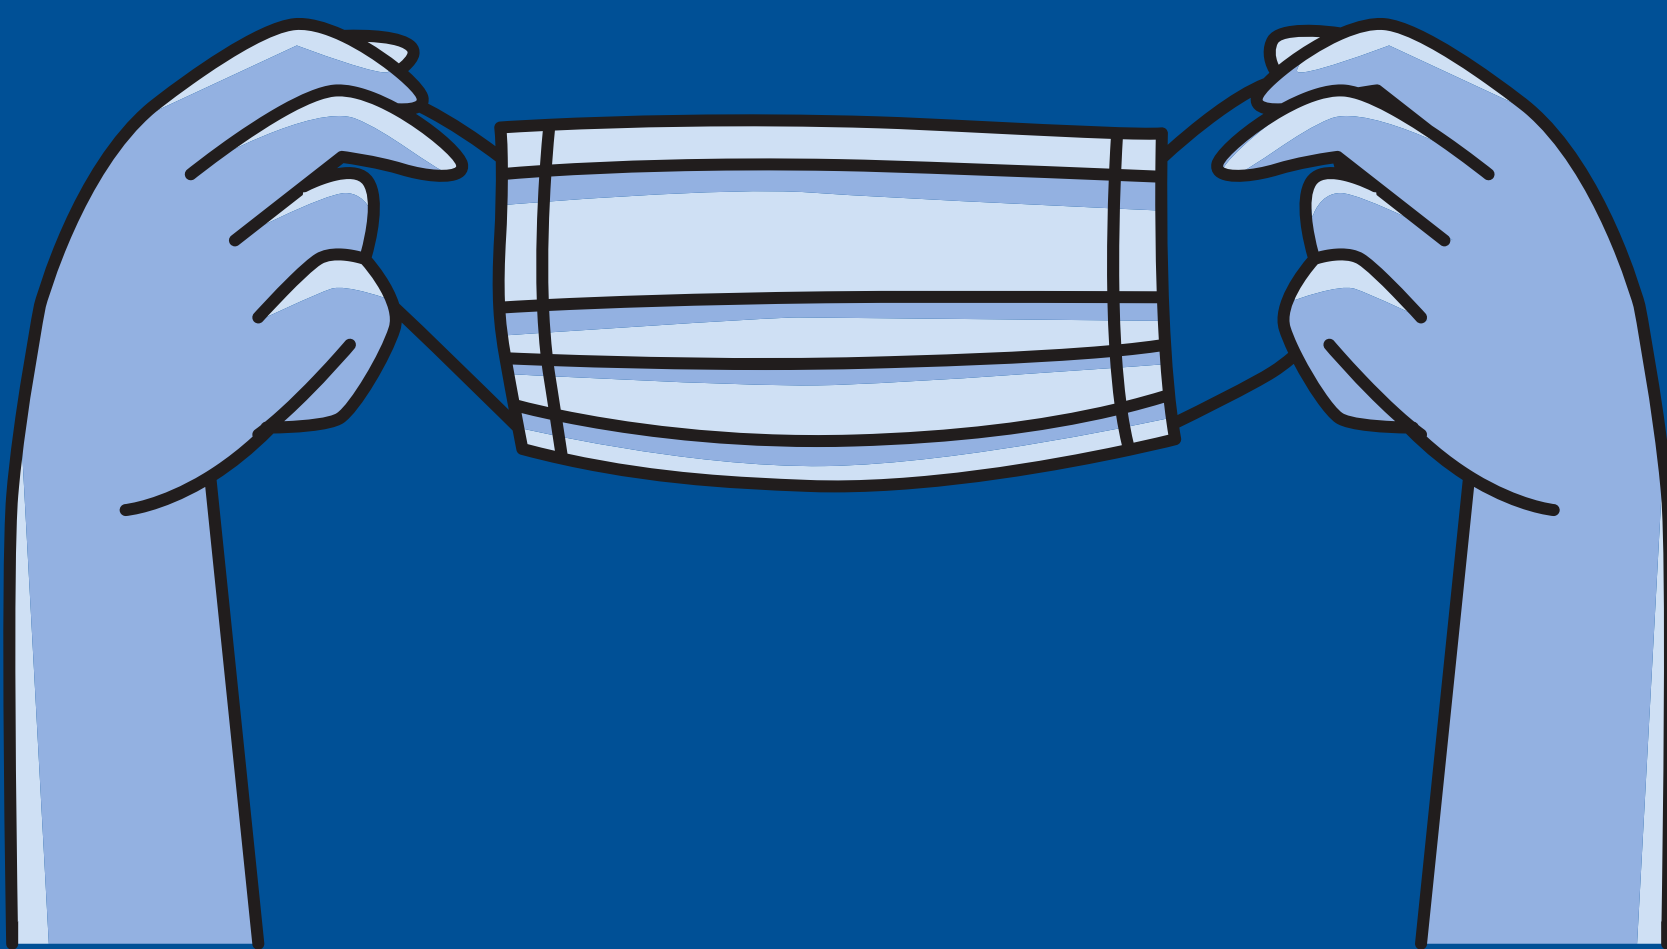

info@donserv.pl